Certikin	KIT	REV: **0** 681 FECHA: **03/04/2005** HOJA: **1/6**

CODIGO **DOSCPI**

DESCRIPCION: **CONTROL CP 2 PH. PPM. CLORO INORGANICO**

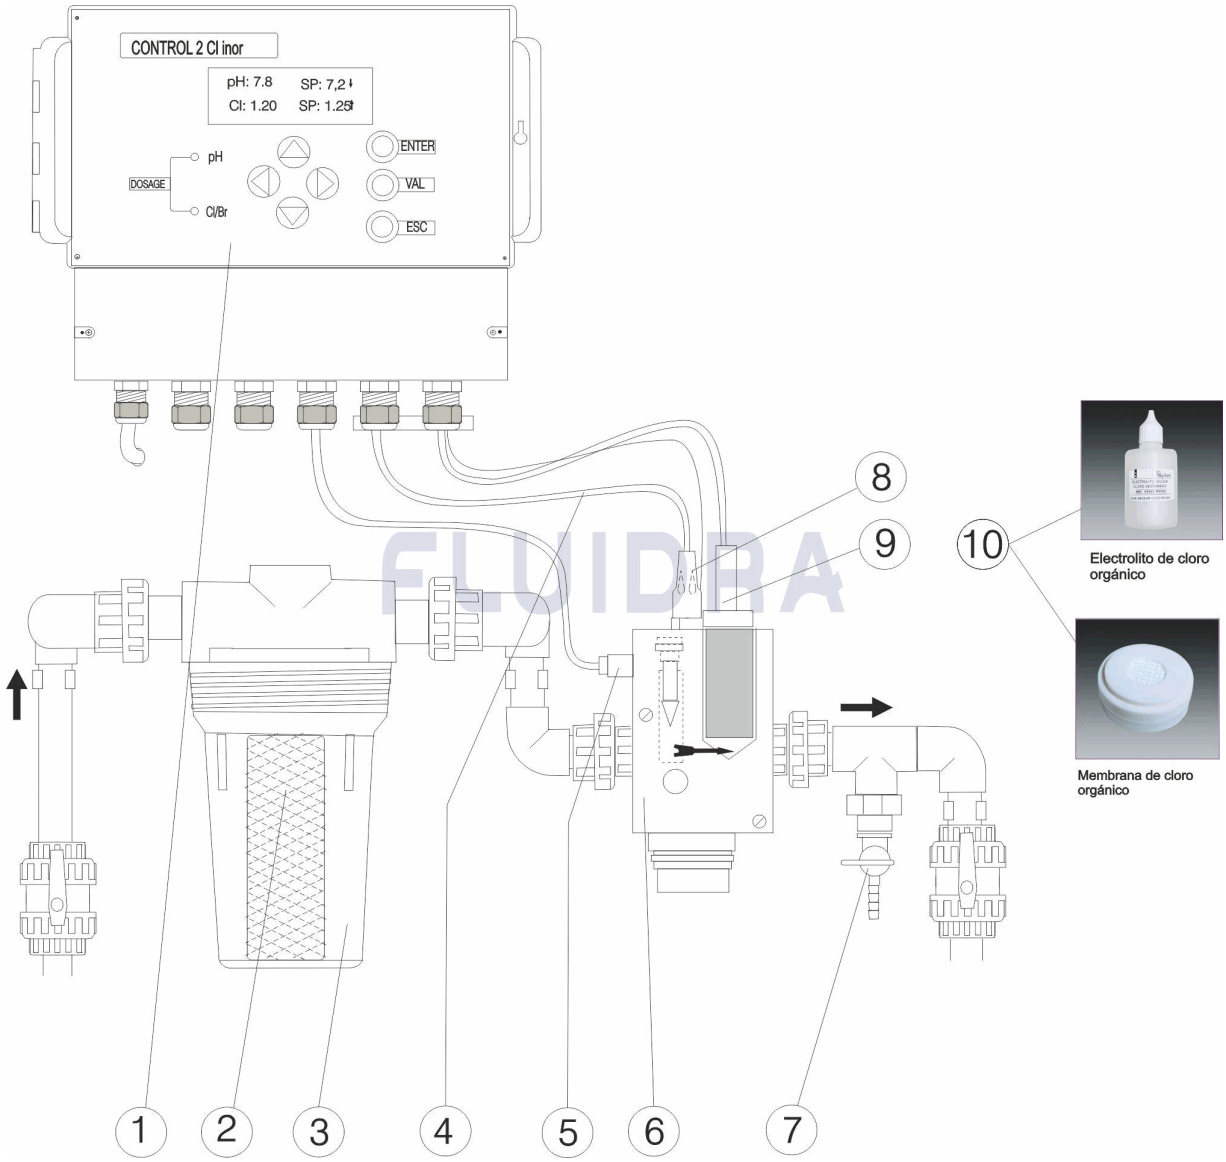

FLUIDRA

ESPAÑOL

POS	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	POS	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	CE08040202	CENTRAL CP2 INORGANICO		6	CE08040114	CAMARA DE ANALISIS	
2	CE08040103	CARTUCHO 5' VIGILANT		7	CE08010205	GRIFO DE PURGA Y JUNTA	
3	CE08040102	PORTACARTUCHOS 5' VIGILANT		8	CE08040107	ELECTRODO DE PH	
4	CE08040105	CABLE ELECTRODO		9	CE08040113	CELULA CLORO INORGANICO	
5	CE08040207	CJTO. DETECTOR INDUCIDO		10	CE08040119	ELECTROLITO Y MEMBRANA INORGANICO	

CODE **DOSCPI**

DESCRIPTION: **CONTRÔLE CP 2 PH. PPM. CHLORE INORGANIQUE**

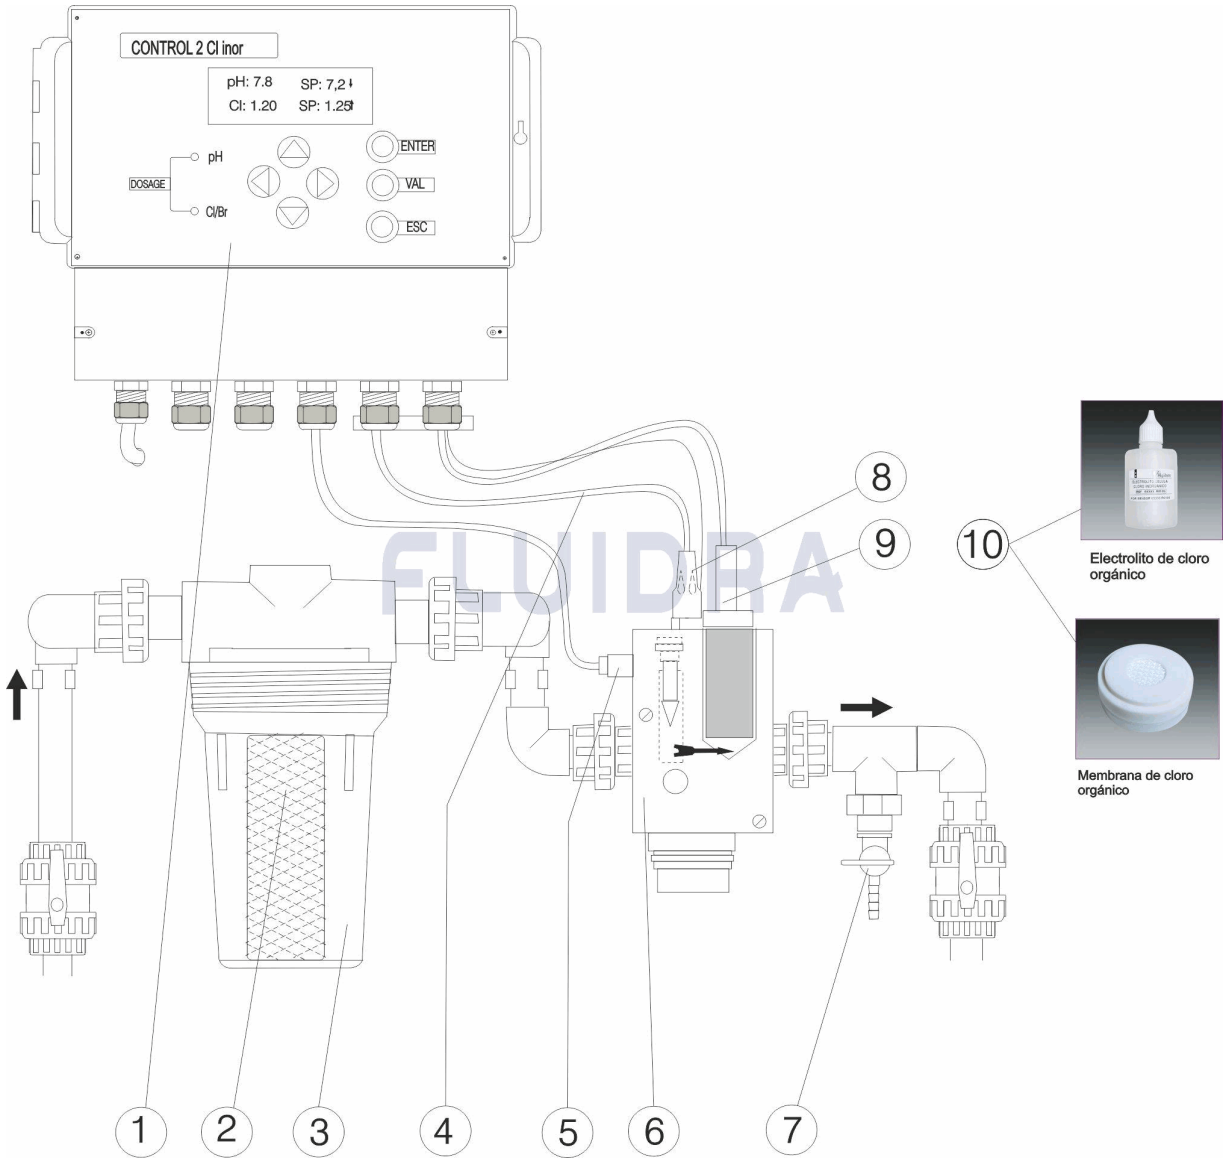

FLUIDRA

FRANCAIS

POS	CODE	DESCRIPTION QUANTITE	POS	CODE	DESCRIPTION QUANTITE
1	CE08040202	CENTRAL CP2 INORGANIQUE	6	CE08040114	CHAMBRE D'ANALYSES
2	CE08040103	CARTOUCHE 5' VIGILANT	7	CE08010205	ROBINET DE PURGE ET JOINT
3	CE08040102	PORTE CARTOUCHES 5' VIGILANT	8	CE08040107	ELECTRODE DE PH
4	CE08040105	CABLE ELECTRODE	9	CE08040113	CELLULE CHLORE INORGANIQUE
5	CE08040207	ENSEMBLE DÉTECTEUR INDUIT	10	CE08040119	ELECTROLYTE ET MEMBRANE INORGANIQ

CODE **DOSCPI**

DESCRIPTION: **CP 2 PH. PPM CONTROL INORGANIC CHLORINE**

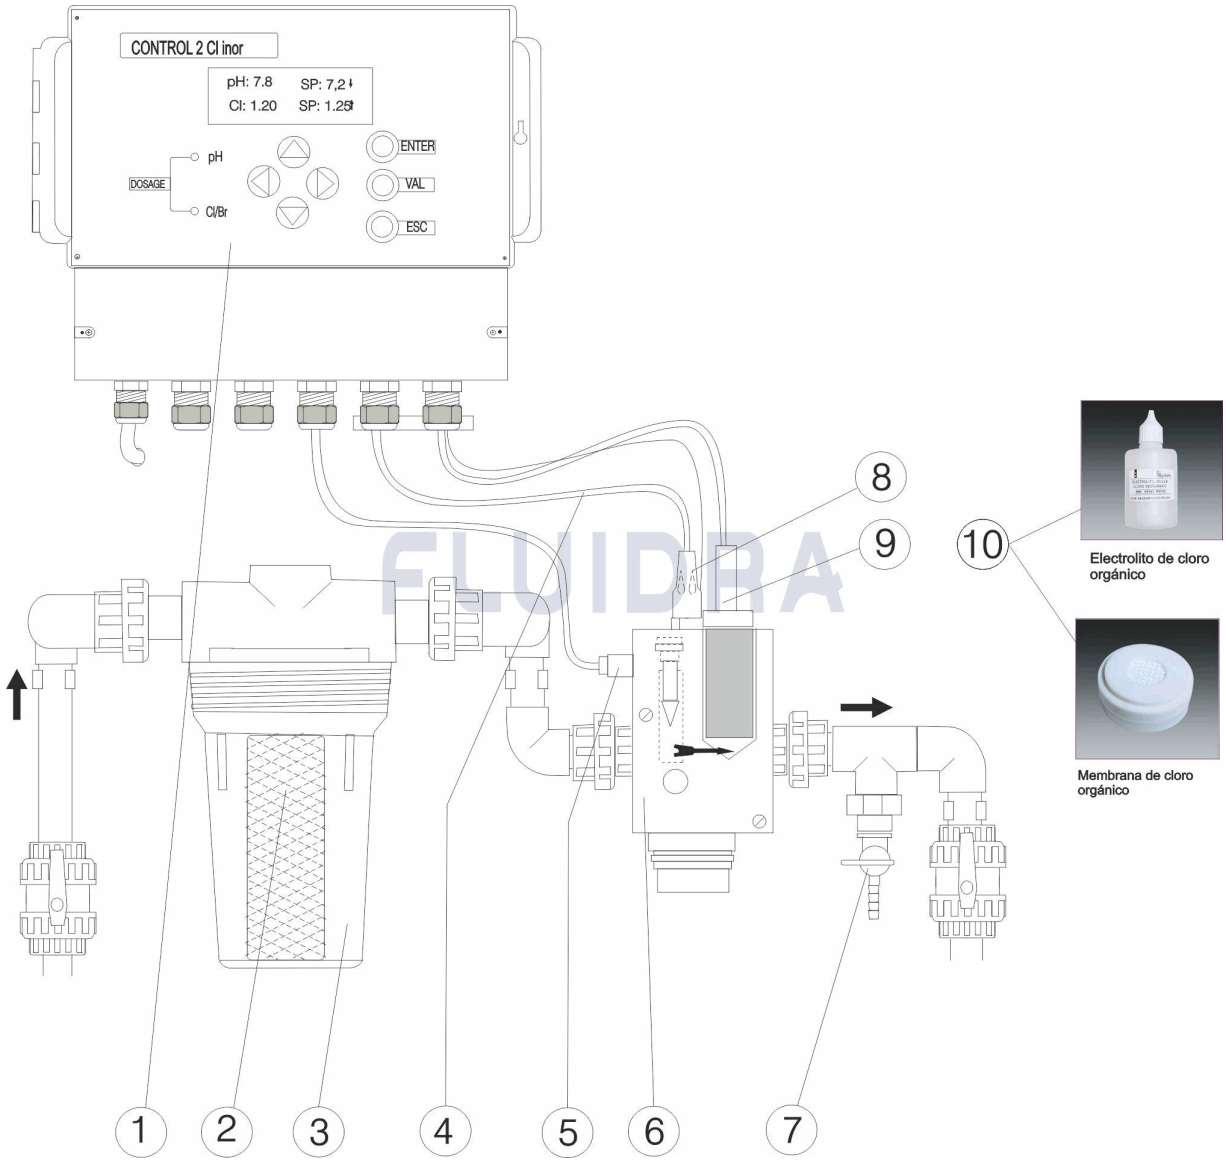

FLUIDRA

ENGLISH

POS	CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	POS	CODE	DESCRIPTION	QUANTITY
1	CE08040202	INORGANIC CP2 CENTRAL UNIT		6	CE08040114	ANALYSIS CHAMBER	
2	CE08040103	5' CARTRIDGE WARNING INDICATOR		7	CE08010205	PURGE VALVE AND SEAL	
3	CE08040102	5' CARTRIDGE WARNING INDICATOR BOX		8	CE08040107	PH ELECTRODE	
4	CE08040105	ELECTRODE CABLE		9	CE08040113	INORGANIC CHLORINE CELL	
5	CE08040207	INDUCED DETECTOR UNIT		10	CE08040119	ELECTROLITE AND INORGANIC MEMBRAN	

CODICE **DOSCPI**

DESCRIZIONE: **CONTROLLO CP 2 PH. PPM. CLORO INORGANICO**

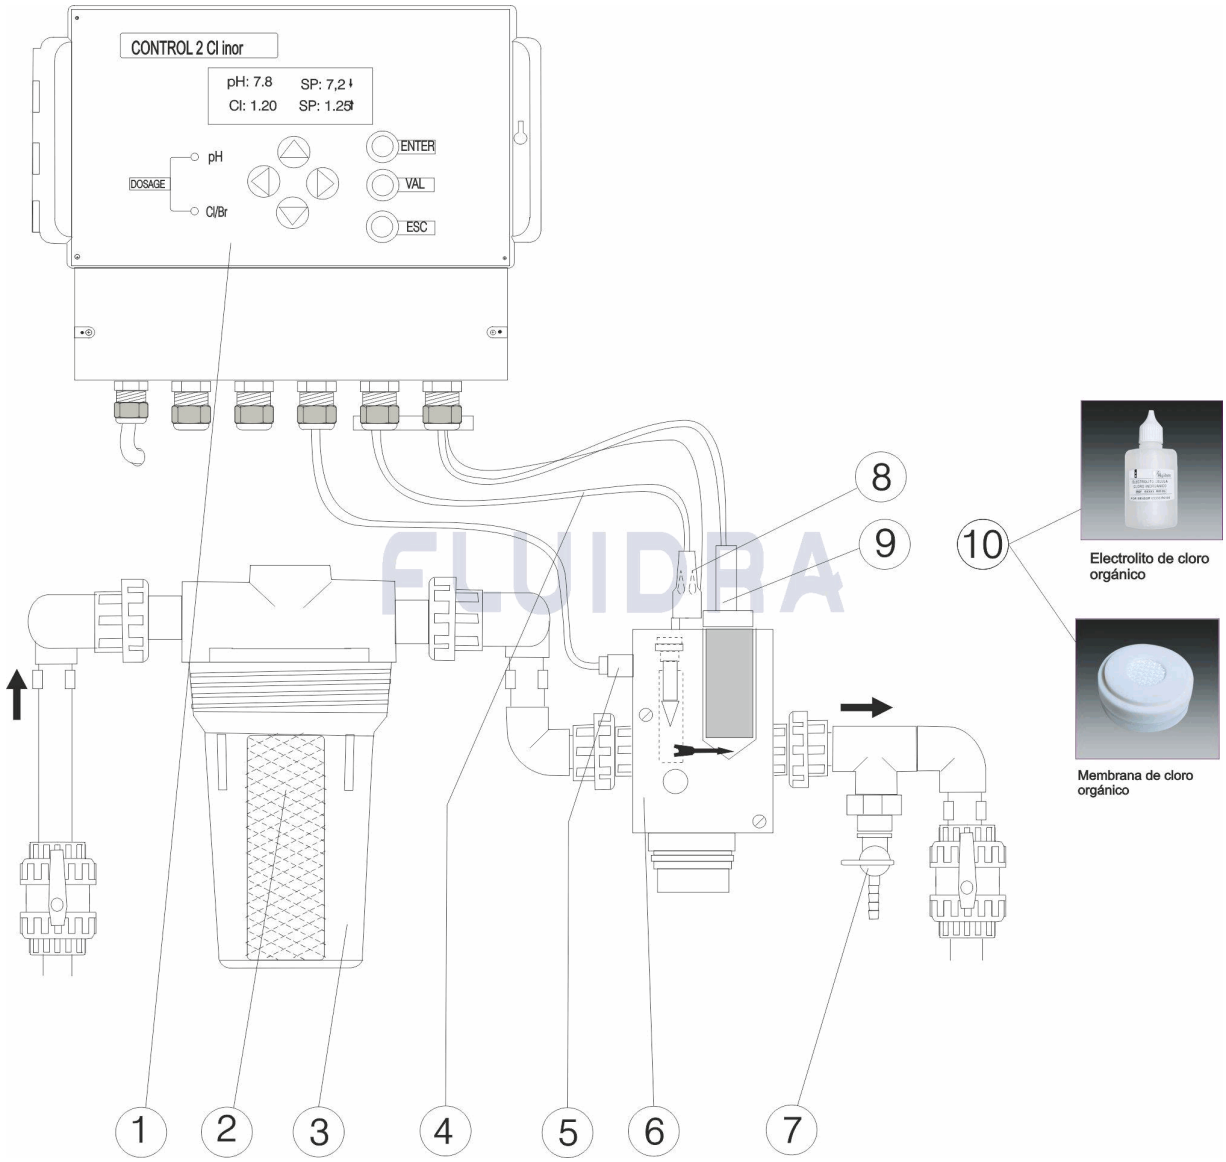

FLUIDRA

ITALIANO

POS	CODICE	DESCRIZIONE QUANTITA'	POS	CODICE	DESCRIZIONE QUANTITA'
1	CE08040202	ALBERO CENTRALE CON TESTA CP2 INOF	6	CE08040114	CAMERA DI ANALISI
2	CE08040103	FILTRINO 5' VIGILANT	7	CE08010205	RUBINETTO DI SCARICO E GUARNIZIONE
3	CE08040102	PORTA FILTRO 5' VIGILANT	8	CE08040107	ELETTRODO DI PH
4	CE08040105	CAVO ELETTRODO	9	CE08040113	CELLULA DI CLORO INORGANICO
5	CE08040207	SET DETETTORE INDOTTO	10	CE08040119	ELETTROLITO E MEMBRANA INORGANICO

CODE **DOSCPI**

BESCHREIBURG: **STEUERUNG CP 2 PH. PPM. CHLOR ANORGANISCH**

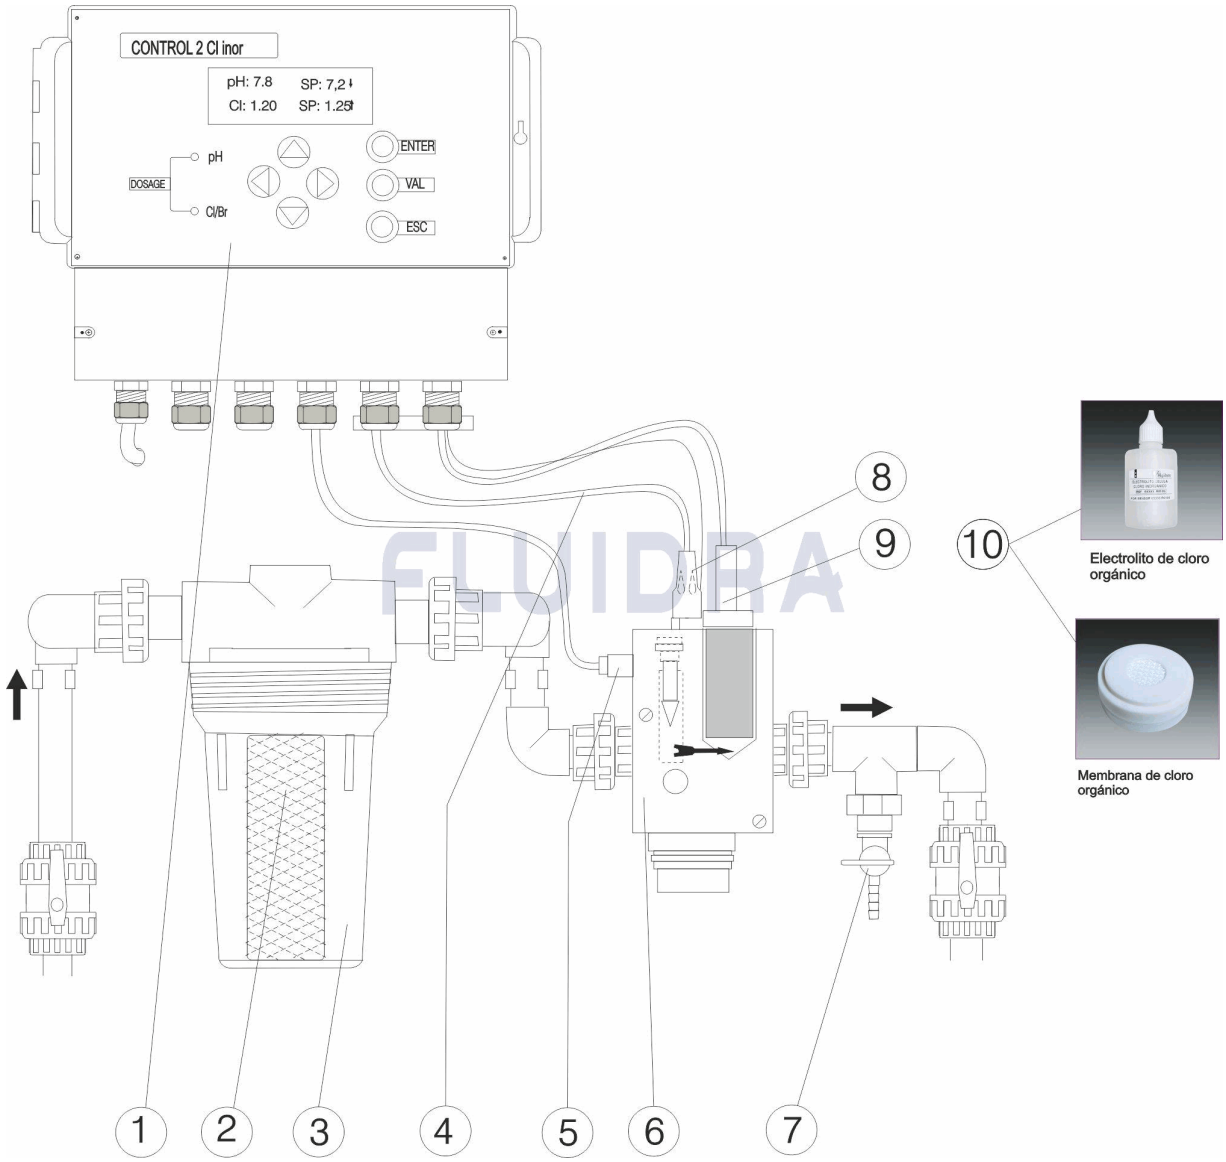

FLUIDRA

DEUTSCH

POS	CODE	BESCHREIBURG	MENGE	POS	CODE	BESCHREIBURG	MENGE
1	CE08040202	ZENTRALE CP2 INORGANISCH		6	CE08040114	ANALYSEKAMMER	
2	CE08040103	KARTUSCHE 5' VIGILANT		7	CE08010205	WASSERHAHN ABLASS UND DICHTUNG	
3	CE08040102	HALTERUNG KARTUSCHEN 5' VIGILANT		8	CE08040107	ELEKTRODE PH	
4	CE08040105	ELEKTRODENKABEL		9	CE08040113	ZELLE CHLOR INORGANISCH	
5	CE08040207	SET DETEKTOR		10	CE08040119	ELEKTROLYT UND MEMBRAN INORGANISC	

CODIGO **DOSCPI**

DESCRICÃO: **CONTROLO CP 2 PH. PPM. CLORO INORGÂNICO**

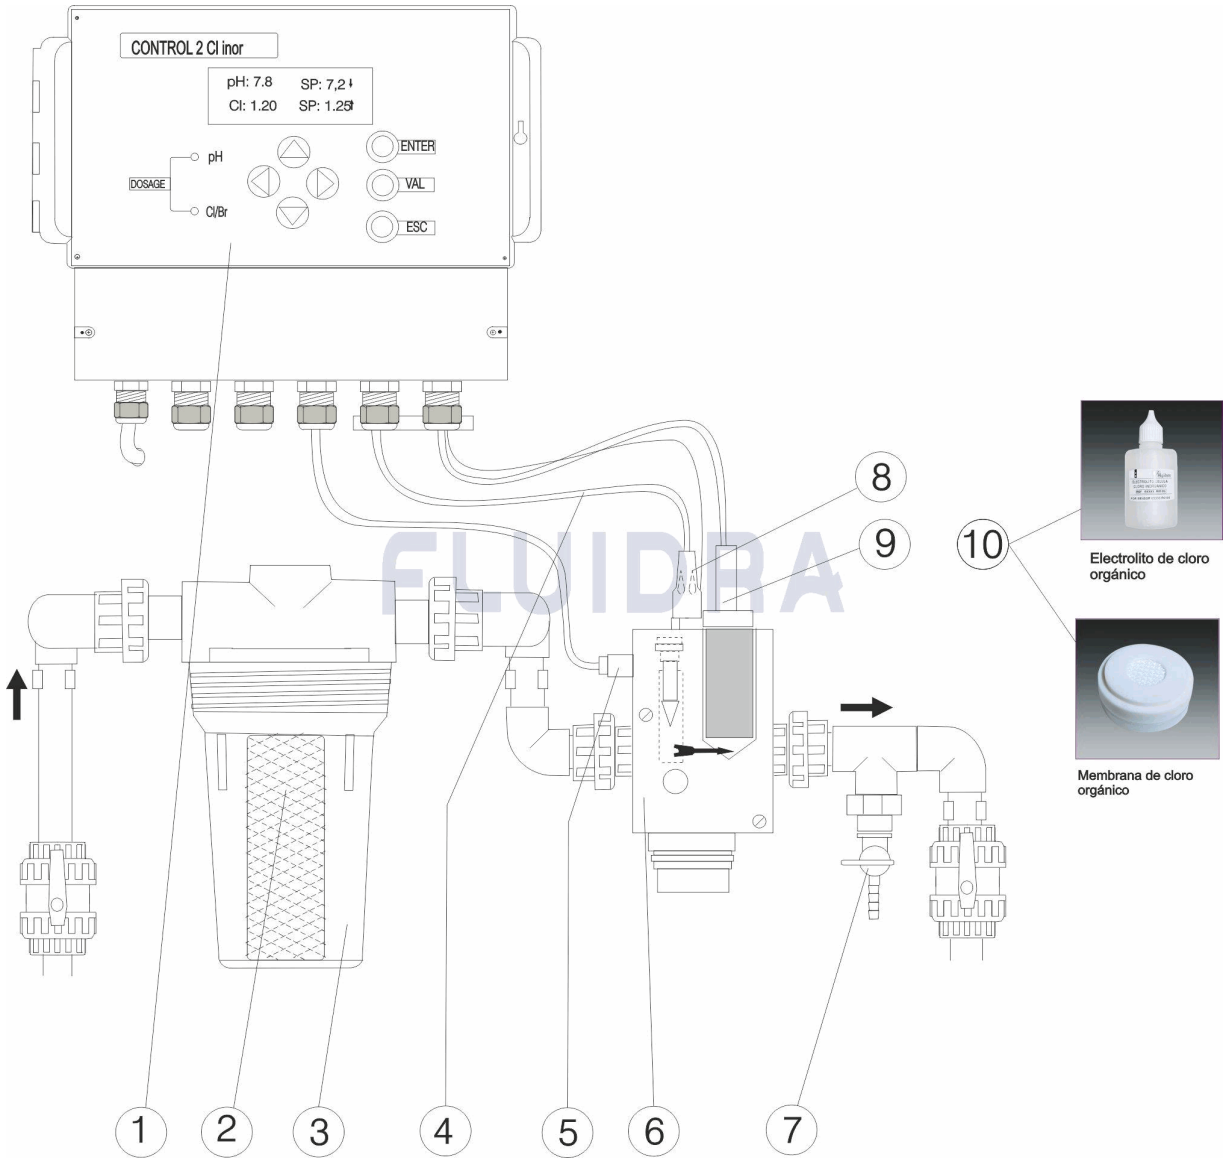

FLUIDRA

PORTUGUES

POS	CODIGO	DESCRICÃO	JANTIDADE	POS	CODIGO	DESCRICÃO	JANTIDADE
1	CE08040202	CENTRAL CP2 INORGÂNICO		6	CE08040114	CÂMARA DE ANÁLISES	
2	CE08040103	CARTUCHO 5' VIGILANT		7	CE08010205	TORNEIRA DE PURGA E JUNTA	
3	CE08040102	FILTRO 5' VIGILANT		8	CE08040107	SONDA PH	
4	CE08040105	CABO SONDA		9	CE08040113	CÉLULA CLORO INORGANICO	
5	CE08040207	CJTO. DETECTOR INDUZIDO		10	CE08040119	ELECTROLITO E MEMBRANA	